

Es un accesorio versátil, práctico y divertido que les brindará energía y protección a los más pequeños de la familia.

Las pulseras de diversos colores que apoyan la tecnología de iones negativos y de infrarrojo lejano, son fabricados en silicón lo cual los hacen resistentes y de uso práctico en cualquier ocasión; su variedad de colores permite que se combinen con diferentes atuendos y al complementarla con la **espiral** de acero inoxidable tendrás un accesorio con magnetismo el cual contrarresta los efectos de la contaminación electromagnética a la cual están cada vez más expuestos los niños y jóvenes.


## INSTRUCCIONES DE CUIDADO

- Evite el contacto con cualquier producto que contenga ácido, alcohol o solventes, como perfume, fijador de cabello, esmalte de uñas, etc.
- Espiral no debe sumergirlos en agua. No se debe usar durante la ducha. Si el producto se moja, séquelos con un paño suave.
- No se recomienda el uso de piezas pequeñas para niños menores de 8 años.

## DISPONIBILIDAD POR PAÍS

Spiral Tech Band	COL	CRI	ECU	GTM	MEX	PAN	PER	SLV
	●	●	●	●	●	●	●	●

SU ASESOR DE BIENESTAR INDEPENDIENTE NIKKEN

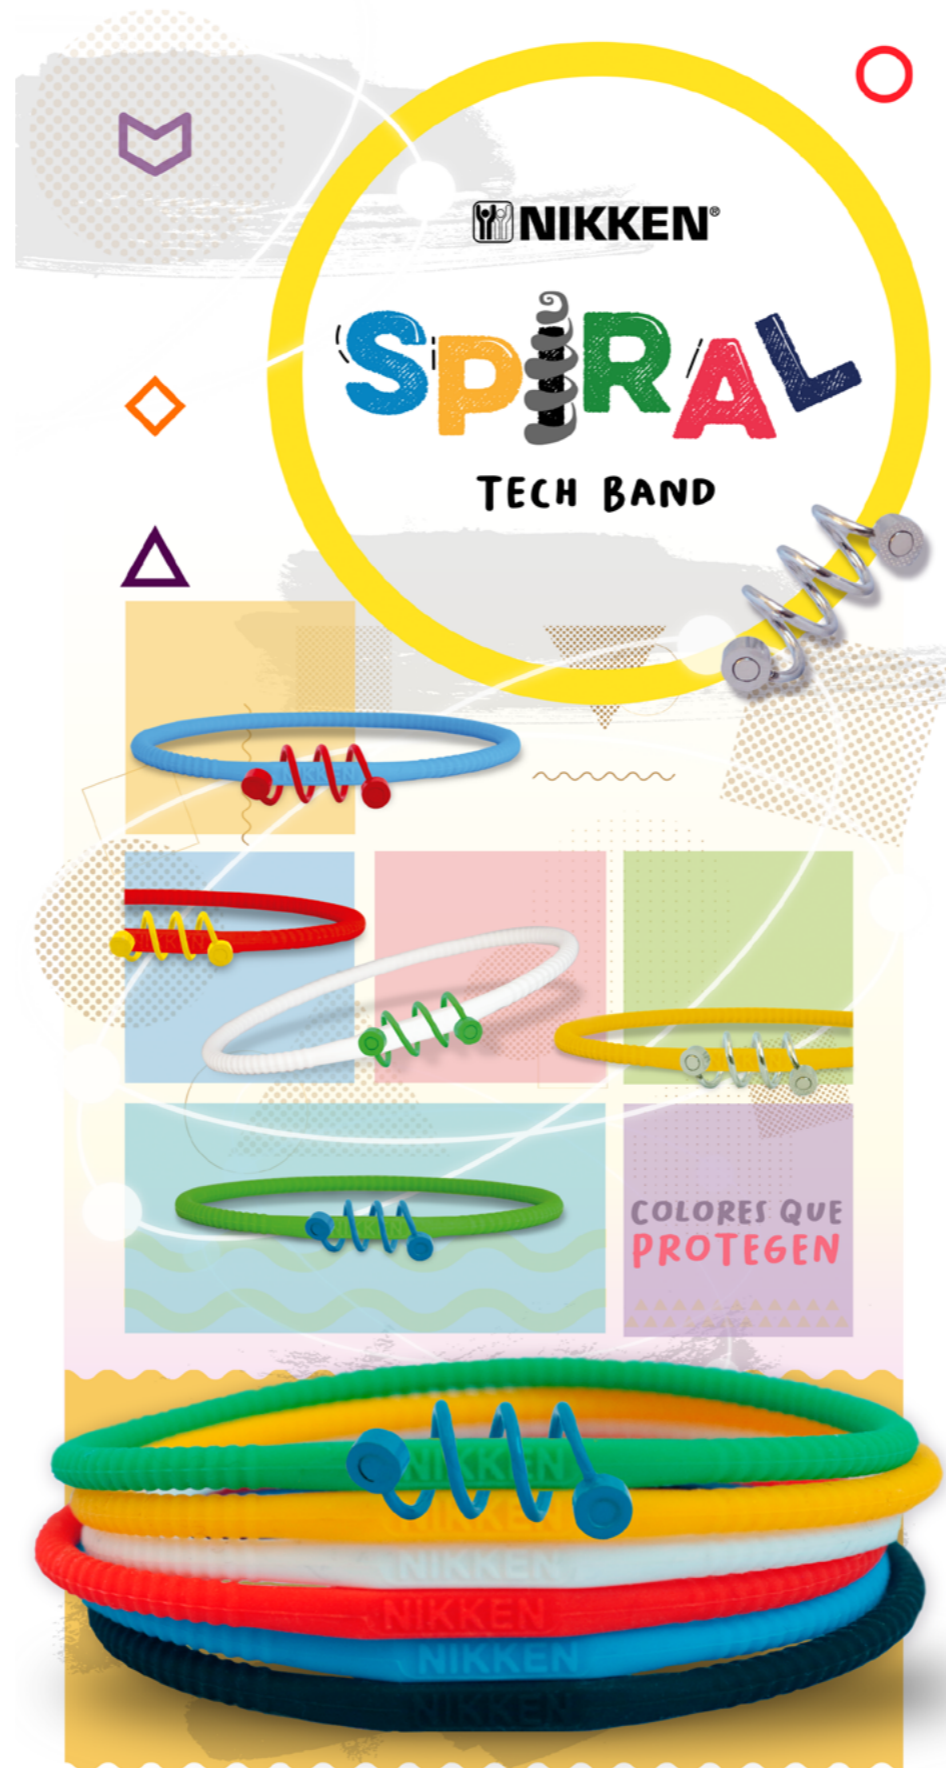

## FICHA DE REFERENCIA RÁPIDA

Spiral Tech Band	Cód.1912
Espiral Magnética	Cód.1910

## TECNOLOGÍA NIKKEN EMPLEADA

**Pulsera:**  
Infrarrojo Lejano e Iones Negativos

**Espiral:**  
Tecnología Magnética 700 gauss

## MATERIALES

- Silicón
- Acero inoxidable 316L
- Neodimio
- Libre de Níquel

## DIMENSIONES

CÓD.	DESCRIPCIÓN	CANT.	GROSOR	DIÁMETRO	LARGO
1912	Pulsera	6 pz	1 mm	6 cm	-
1910	Espiral	1 pz	1 mm	5 mm	15 mm

## INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA

90 días después de la fecha de compra en contra de defectos de fabricación. La garantía no cubre el desgaste por el uso normal o inadecuado.

## INSTRUCCIONES DE USO

Coloque la pulsera de silicón en la primera ranura del espiral. Posteriormente sostenga el extremo del espiral junto con la pulsera y darle vueltas a la pulsera conforme al espiral hasta que quede en la parte interna.

### PRECAUCIÓN:

Si utiliza un dispositivo médico como un marcapaso o un aparato magnéticamente sensible como un implante quirúrgico, no debe usar este producto y debe consultar a su médico antes de usar productos magnéticos. No coloque los productos magnéticos en contacto directo con artículos sensitivos al magnetismo como relojes, tarjetas de crédito, equipo electrónico portátil, USB etc.